



**VIAS  
DIGESTIVAS**



**VIAS  
RESPIRATÓRIAS**



**VIAS  
URINÁRIAS**



**DRENAGEM**



**ACESSO  
VASCULAR**

**MAIS OPÇÕES, MELHOR SAÚDE**

# NOSSA PROPOSTA



AMPLO PORTFÓLIO de produtos.

PARCEIRO ESTRATÉGICO para os centros hospitalares.

Oferecemos uma EXPERIÊNCIA COM QUALIDADE nos tratamentos.

Serviço confiável, PRÓXIMO E DINÂMICO.

Produtos com padrões de QUALIDADE INTERNACIONAL.

CAPACITAÇÃO para a utilização correta dos produtos.

## NOSSO PORTFÓLIO DE PRODUTOS

AV

ACESSO VASCULAR

PAG 3

VD

VIAS DIGESTIVAS

PAG 10

VR

VIAS RESPIRATÓRIAS

PAG 16

VU

VIAS URINÁRIAS

PAG 18

DR

DRENAGEM

PAG 20

OT

OUTROS

PAG 23




### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano Mono Lumen grau médico RADIOPACO.
- Marcações centimetradas.
- Extremidade (distal) aberta.
- Marcado por centímetro a partir de 4 cm a 24 cm em toda sua extensão, garante o correto posicionamento.
- Fácil manuseio (manipulação) e deslizamento ao introduzir.
- Possui um conector luer lock na sua extremidade proximal.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

#### Mono Lumen

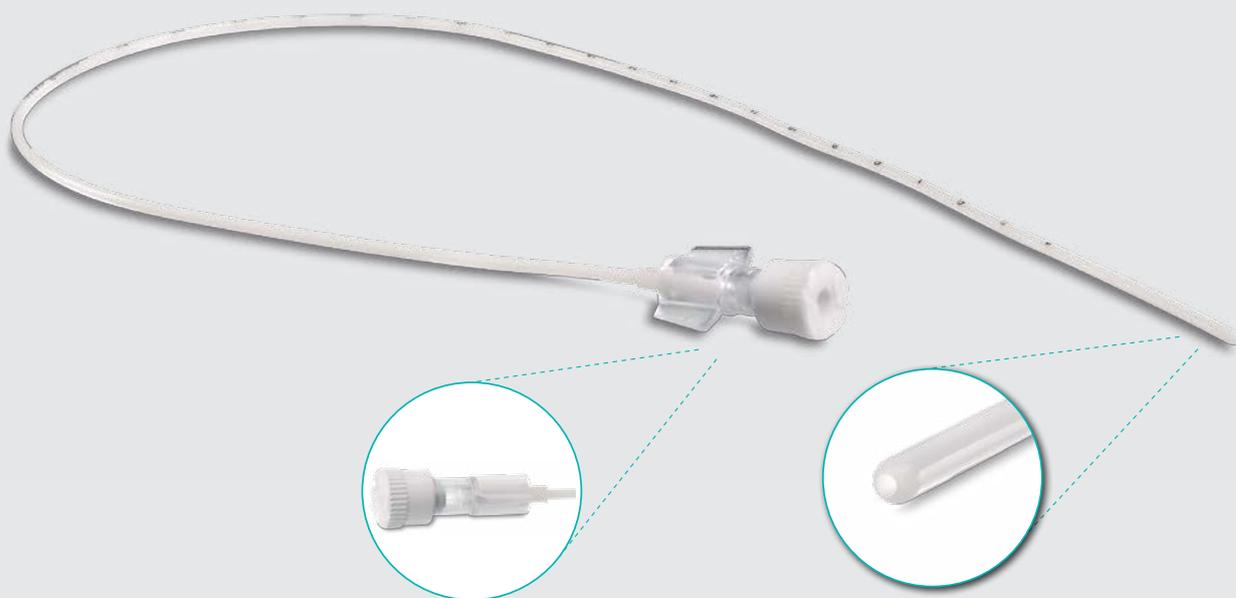

Ponta Arredondada

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510008

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (mm)
5002.25	2,5	0,80	0,40	305
5002.35	3,5	1,15	0,60	410
5002.40	4,0	1,40	0,78	410
5002.50	5,0	1,60	0,80	410
5002.60	6,0	2,00	1,00	410


### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano RADIOFACO grau médico.
- Dimensões e lúmenes adequados para recém nascidos de baixo peso e prematuros.
- Cateter 1 Via, Mono Lúmen.
- Marcações centimetrada com ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter.
- Introdutor peel off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR, com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo.

#### O kit inclui:

- 1 Cateter Percutâneo Mono lúmen em Poliuretano
- 1 Introdutor peel off (Bipartido)
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 1 Conetor safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

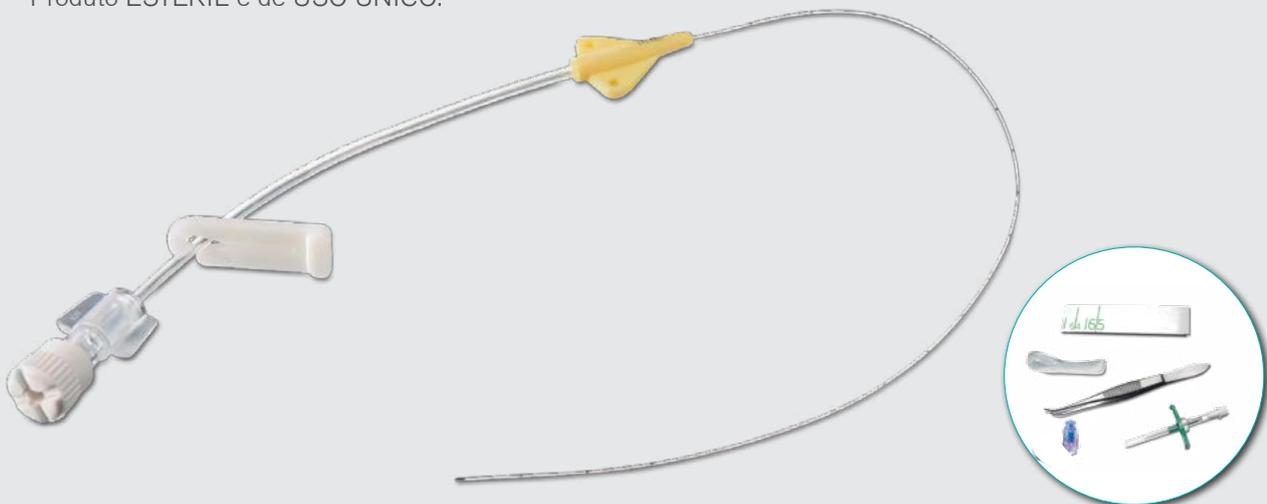

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510018

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm)	Introdutor (FR)	Comprimento (cm)	Lúmen
5003.02.15-1	2,0	0,62 x 0,30	2,0	15	1
5003.02.30-1	2,0	0,62 x 0,30	2,0	30	1
5003.03.30-1	3,0	1,00 x 0,50	3,0	30	1
5003.03.60-1	3,0	1,00 x 0,50	3,0	60	1
5003.04.60-1	4,0	1,35 x 0,80	4,0	60	1
5003.05.60-1	5,0	1,65 x 1,05	5,0	60	1



## CATETER PICC DUPLO LUMEN POLIURETANO

### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano RADIOPACO grau médico.
- Dimensões e lúmenes adequados para recém nascidos de baixo peso e prematuros.
- Cateter 2 Vias: Duplo Lúmen, para a administração de soluções incompatíveis.
- Marcações centrimétradas e ponta pintada para verificar uma correta colocação e a extração total do cateter.
- Introdutor peel off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR, com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.

#### O kit inclui:

- 1 Cateter Percutâneo Duplo em Poliuretano
- 1 Introdutor peel off (Bipartido)
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 2 Conetor safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510018

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm)	Introdutor (FR)	Comprimento (cm)	Lúmen
5003.02.20-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	2,0	20	2
5003.02.30-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	2,0	30	2
5003.03.50-2	3,0	0,95 x (0,30 x 2)	3,0	50	2
5003.04.60-2	4,0	1,40 x (0,40 x 2)	4,0	60	2


### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Silicone RADIOPACO grau médico.
- Marcações a cada 1 cm.
- Cateter de 1 Via: Mono Lúmen.
- Garrote de silicone que não lesiona a pele e se adapta à superfície de fixação.
- Introdutor Peel Off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR, com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.

#### O kit inclui:

- 1 Cateter Percutâneo Mono lúmen em silicone
- 1 Introdutor peel off (Bipartido)
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 1 Conetor safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone
- 1 Extensor em PVC com conectores luer lock e clamp

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510021

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Ext. (mm)	Diâmetro Inter. (mm)	Comp. Cateter (Cm)	Introdutor		Lúmen
					Cateter (Fr)	Agulha (Ga)	
5004.19.50-1	1,9	0,60	0,28	50	2,0	22	1
5004.02.30-1	2,0	0,62	0,30	30	2,0	22	1
5004.03.50-1	3,0	1,00	0,50	50	3,0	19	1
5004.04.65-1	4,0	1,40	0,75	65	4,0	17	1
5004.05.65-1	5,0	1,70	0,80	65	5,0	15	1



## CATETER PICC DUPLO LUMEN SILICONE


### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Silicone RADIOPACO grau médico.
- Marcações a cada 1 cm.
- Catéter 2 vias: Duplo Lúmen
- Garrote de silicone que não lesiona a pele e se adapta à superfície de fixação.
- Introduzido r Peel Off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR, com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo venoso.

### O kit inclui:

- 1 Cateter Percutâneo Duplo lúmen em silicone
- 1 Introduzidor peel off (Bipartido)
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 2 Conetor safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone
- 2 Extensores em PVC com conetores luer lock e clamp

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

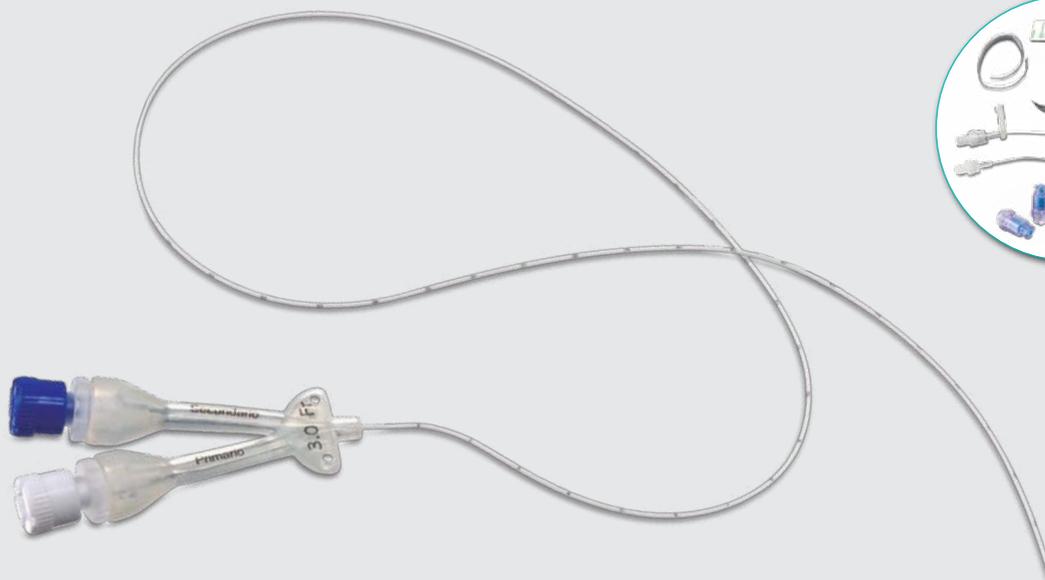

### Informações Técnicas / Modelos


Cadastro Anvisa nº 81158510023

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Ext. (mm)	Diâmetro Inter. (mm)	Comp. Cateter (Cm)	Introduzidor		Lúmen
					Cateter (Fr)	Agulha (Ga)	
5008.03.50-2	3,0	1,00	0,20 x 2	50	3,0	19	2
5008.04.65-2	4,0	1,40	0,30 x 2	65	4,0	17	2
5008.05.65-2	5,0	1,70	0,40 x 2	65	5,0	15	2

### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter 100% Poliuretano RADIOPACO com câmara de refluxo transparente para verificação do retorno sanguíneo.
- Introdutor peel off e agulha com orifício lateral para os tamanhos 2 e 3 FR.
- Usado em pacientes que necessitam de colocação de cateteres PICC.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

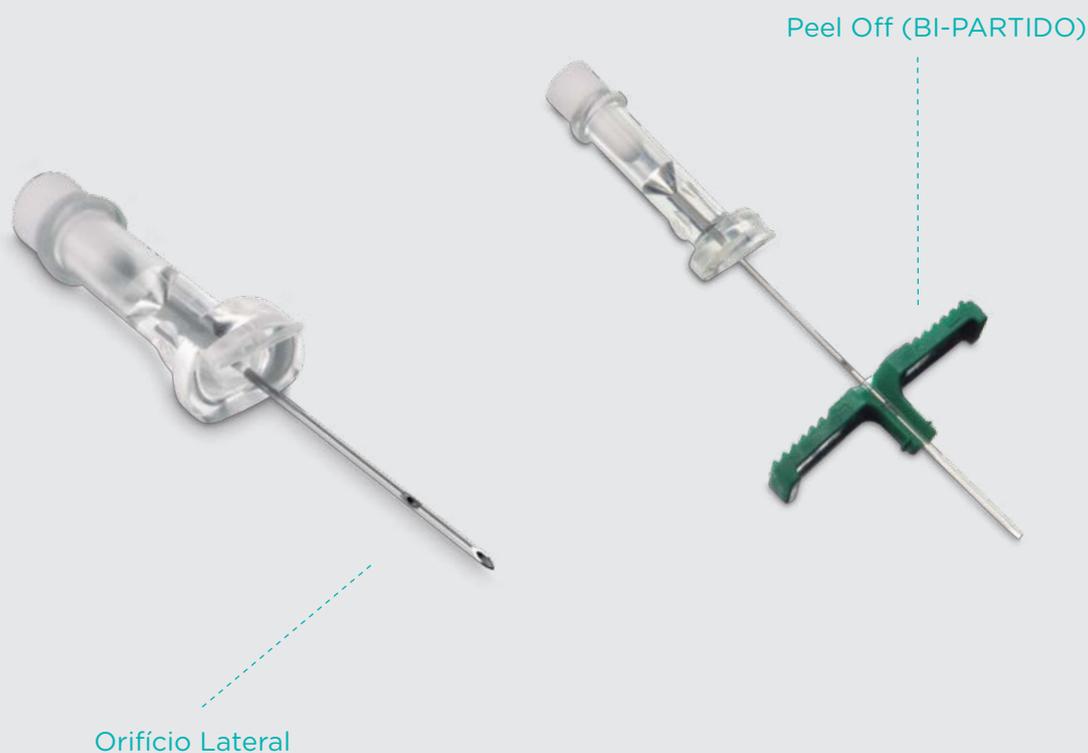

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa: Standard nº81158510022  
Silflash nº81158510024

Código	Calibre (Fr.)	Calibre (Ga)	Di Metro Interno (mm)	Di Metro Externo (mm)
5006.02-8	2,0	22	0,76	1,12
5006.03-8	3,0	19	1,12	1,47
5007.04-7	4,0	17	1,52	1,88
5007.05-7	5,0	15	1,88	2,24

## CONECTOR SAFETY – PRESSÃO NEUTRA

### DETALHES DO PRODUTO

- Conector de segurança pressão neutra.
- Válvula -free, isento de látex.
- Compatível com conexões Luer-Lock e Luer-Slip.
- Vazão de fluxo: 360 ml/min.
- Volume de priming: 0,06 mL.
- Número de ativações: 200.
- Acesso rápido e seguro de todas as vias de infusão.
- Compatível com todos os acessos intravenosos.
- Corpo transparente e resistente.
- Troca do produtos: havendo a troca das linhas de infusão seguir conforme o protocolo da instituição.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510019

Código	Pressão	Resistencia máxima a pressão (Kpa)	Volume de armazenamento de líquido (mL)	Velocidade de Fluxo (mL/min)
7001-9	Neutra	150	0.06	220-260



### DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone com linha RADIOPACA.
- Extremo distal fechado e arredondado com 2 orifícios laterais.
- Marcado a 20 e 30 cm para os códigos 2004.04 e 2004.06 e 20, 30, 40 e 50 cm para os códigos 2004.07 e 2004.09.
- Não produz úlceras de pressão.
- Maior conforto para o paciente.
- Sem atrito doloroso durante a colocação.
- Menor risco de obstrução por flexão ou acúmulo de solução.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510001

Sonda Nasogástrica - Pediátrico				
Código	FR	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Comprimento (mm)
2004.04	4.0	1.40	0.75	450
2004.06	6.0	2.00	1.00	450
2004.07	7.0	2.30	1.25	1050
2004.09	9.0	3.00	1.75	1050

2 perfurações laterais



## CONJUNTO PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA - PEG

### DETALHES DO PRODUTO

- Sonda 100% de Silicone grau medico com linha radiopaca
- Marcações centimentradas
- Colocação menos traumática

#### O kit inclui:

- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca.
- 1 Laço flexível multifilamento para a fácil colocação fácil.
- 1 Fio guia metálico.
- 1 Bisturi Safety.
- 2 Conectores.
- 1 Clamp de fixação ergonômico.
- 1 Anel de travamento com grampo e campo cirúrgico estéril.
- 1 Campo cirúrgico fenestrado.

Colocação menos traumática.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510015

Código	CH/FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (cm)	Agulha introdutora (GA)
2003.14.70	14	4,70	3,00	70	14
2003.16.90	16	5,30	3,50	90	14
2003.18.90	18	6,00	4,00	90	14
2003.20.60	20	6,70	4,00	60	14
2003.22.90	22	7,30	5,00	90	14
2003.24.60	24	8,00	5,00	60	14

**DETALHES DO PRODUTO**

- Sonda 100% de Silicone grau medico com linha radiopaca
- Marcações centimetradas
- Colocação menos traumática

**O kit inclui:**

- 1 Sonda 100% de silicone com linha radiopaca.
- 1 Laço flexível multifilamento para a colocação fácil.
- 1 Fio guia metálico.
- 1 Bisturi Safety.
- 2 conectores.
- 1 Clamp de fixação ergonômico.
- 1 Anel de travamento com grampo e campo cirúrgico estéril.
- 1 Campo cirúrgico fenestrado.
- 1 Agulha de Punção.
- 3 Agulhas Hipodermicas.
- 1 Seringa.
- 1 Clamp.
- 1 Tesoura.
- 1 Pinça.
- 5 Gazes.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

**Informações Técnicas / Modelos**

Cadastro Anvisa nº 81158510026


Código	Diâmetro FR	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento (cm)
2011.20.60	20	6,70	4,00	60
2011.24.60	24	8,00	5,00	60



## SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO

### DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone grau médico com linha RADIOFACA.
- Demarcado em centímetros para identificar a profundidade abdominal, com balão e anel para fixação.
- Grande variedade de tamanhos e calibres disponíveis.
- Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda.

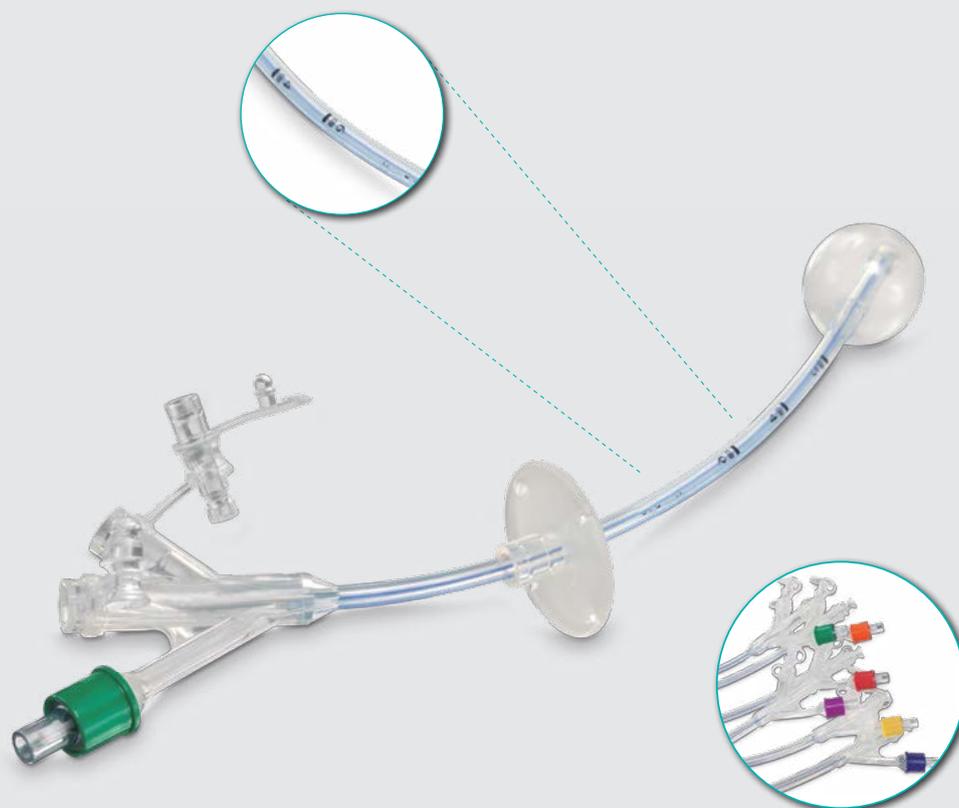

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510011

Sonda para Gastrostomia com Balão - Pediátrica				
Código	FR	Ø Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado(ml)
2008.12	12	4.00	240	5
2008.14	14	4.70	240	5
2008.16	16	5.30	240	5
2008.18	18	6.00	240	5
2008.20	20	6.70	240	5

Sonda para Gastrostomia com Balão - Adulto				
Código	FR	Ø Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado(ml)
2001.18	18	6.00	240	20
2001.20	20	6.70	240	20
2001.22	22	7.30	240	20
2001.24	24	8.00	240	20

VD



# VIAS DIGESTIVAS

## BOTÃO GÁSTRICO


### DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone grau médico com cabeça **RADIOPACA**.
- Marcações centimentradas.
- Sistema de ancoragem segura impede mover o tubo de alimentação fora de posição.
- Tubo de alimentação com conector com trava de segurança.
- Não precisa manutenção.

### O kit inclui:

- 1 Botão gástrico (Boton).
- 1 mandril para botão gástrico
- 1 Medidor de Parede abdominal.
- 2 Tubos um para alimentação outro para decompressão.
- 1 Seringa de 60 ml bico Cateter.
- 2 Anéis.

Produto **ESTÉRIL** e de **USO ÚNICO**.

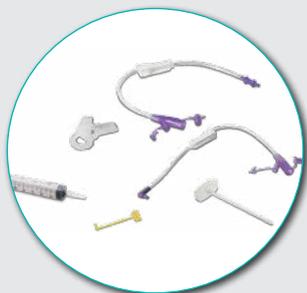

Cadastro Anvisa nº 81158510012

### Informações Técnicas / Modelos

Código	Diâmetro (Fr)	Diâm. Externo (mm)	Comprimento (cm)
2002.18.12	18	6,00	1,20
2002.18.17	18	6,00	1,70
2002.18.24	18	6,00	2,40
2002.18.34	18	6,00	3,40
2002.20.17	20	6,70	1,70
2002.20.24	20	6,70	2,40
2002.24.12	24	8,00	1,20
2002.24.17	24	8,00	1,70
2002.24.24	24	8,00	2,40
2002.24.34	24	8,00	3,40
2002.24.44	24	8,00	4,40



## TUBO DE EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO E DESCOMPRESSÃO DE BOTÃO GÁSTRICO

### DETALHES DO PRODUTO

- Grande alongamento.
- Colocação menos traumática para o paciente.
- Não precisa manutenção.
- Kit de substituição disponível: com dois tubos.
- Tubo de alimentação com conector com trava de segurança.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510017


Tubo de Extensão para Alimentação Botão Gástrico		
Código	Comp. Tubo de alim. Em bolo (cm)	Comp. Tubo de alim. Continua (cm)
2010	30	50



### DETALHES DO PRODUTO

- Canula 100% Silicone translúcida.
- As prongas em silicone são ajustáveis, flexíveis e com extremidades arredondadas. Não produz dermatite ou úlceras de pressão.
- Extensão em tubo vinílico, com interior em formato de trevo, para evitar acotovelamento e garantir um fluxo contínuo.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

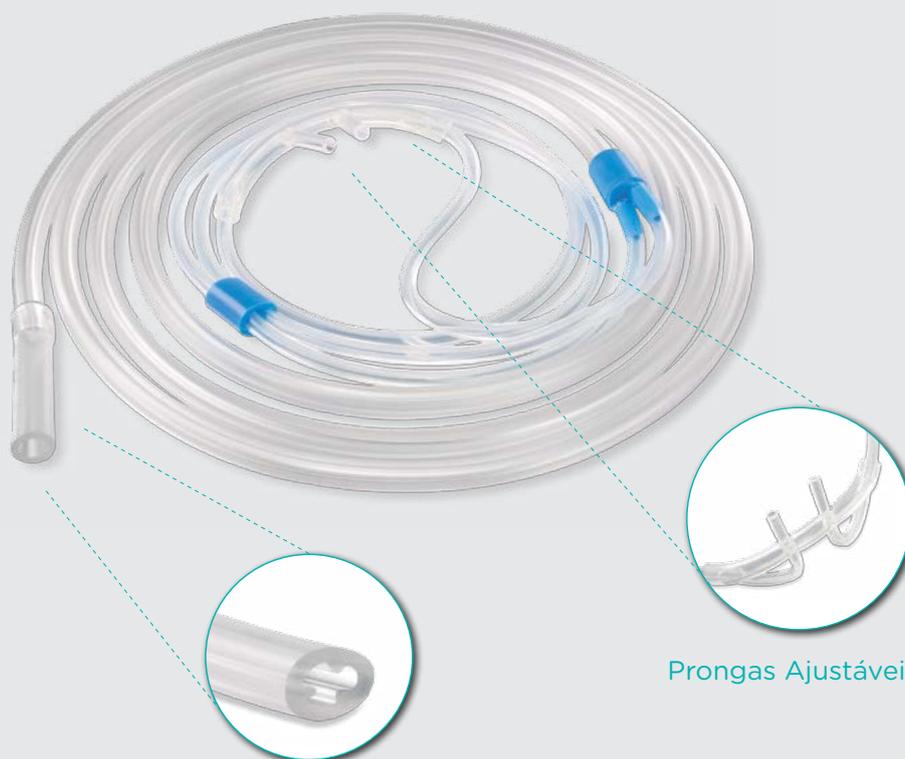

Prongas Ajustáveis

### Informações Técnicas / Modelos

Anvisa nº 81158510004  
Anvisa nº 81158510010

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento Prolongador
1003.06	06 (Neonatal)	2,30	1,40	2100
1003.09	09 (Pediátrica)	3,30	2,00	2100
1003.12	12 (Adulto)	4,00	2,50	2100
1001.12.75	12 (Adulto)	4,00	2,50	75000



### DETALHES DO PRODUTO

- Adaptável a fossa nasal.
- Não produz lesões e pressão no septo.
- Capacidade de se adaptar ao sistema CPAP ou bolhas.
- Cânula 100% silicone transparente.

#### O kit inclui:

- 1 Cânula nasal em 100% Silicone.
- 2 Tubos corrugados e flexíveis (permite a mobilidade sem o risco de dobras).
- 1 Tubo corrugado extensor de 40 cm.
- 1 Fita Hidrofílica.
- 1 gorro de algodão com ajuste e fixação dos tubos.
- 5 Conectores para os vários tipos de equipamentos e ventiladores.
- 1 Fita hidrocoloide.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510007


Código	FR	Diâmetro Externo cânulas (orifício nasal) (mm)	Separação entre Cânulas (mm)	Altura Orifício Nasal (mm)	Recomendação segundo peso do paciente
1002.08	08	2,70	2,70	9,00	Menos de 1000g
1002.10	10	3,30	2,70	9,00	De 1000 a 1500g
1002.12	12	4,00	4,00	10,00	De 1500 a 2000g
1002.15	15	5,00	4,50	12,50	Mais de 2000g



### DETALHES DO PRODUTO

- O sistema fechado reduz o risco de infecção.
- Obtenção de urina para fins de diagnóstico.
- Bureta para a medição da urina drenada de 150 ml.
- Conector com ponta de silicone para coleta de amostra.
- Sonda 100% silicone radiopaco com extremidade fechada.
- Conector de silicone rígido com ponto de coleta de amostra e adaptável ao cateter ou sondas.
- Clamp para esvaziar o bureta.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

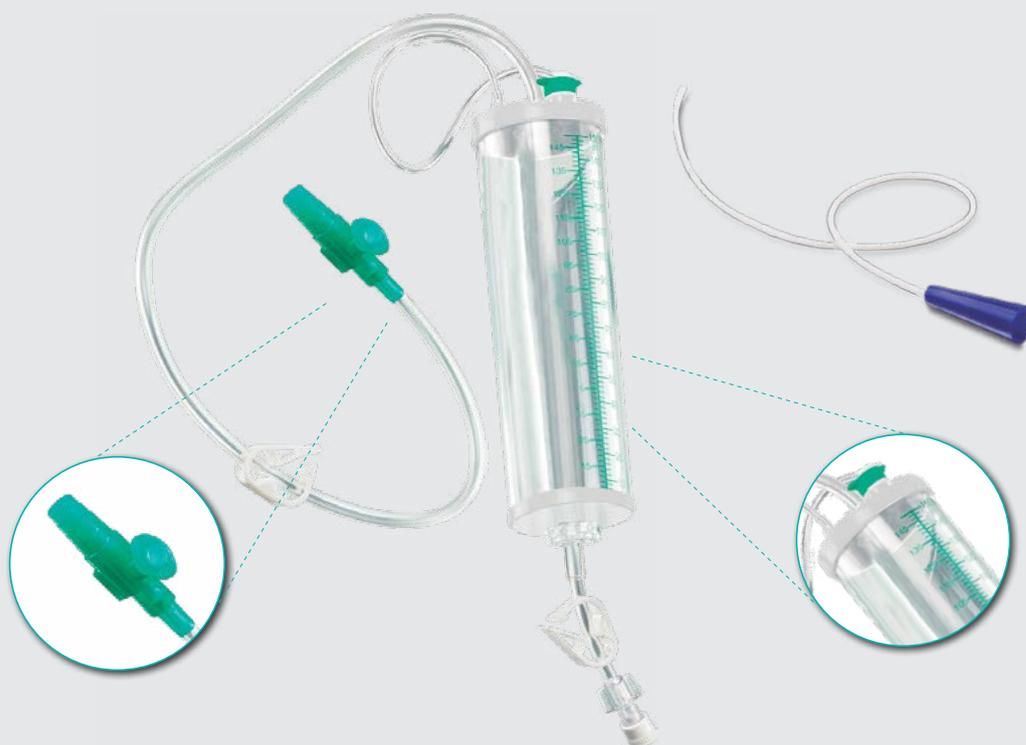

Cadastro Anvisa nº 81158510009  
Cadastro Anvisa nº 81158519001

### Informações Técnicas / Modelos

Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)
4002.04	04	1,40	0,75
4002.06	06	2,00	1,00
4002.08	08	2,70	1,50
4004.06	SEM SONDA	2,00	1,00


Volume da bureta (150 ml)

## SONDA FOLEY COM BALÃO

### DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone transparente com linha radiopaca.
- Balão tem a função de retenção da sonda na bexiga.
- A sonda possui orifício que permite o esvaziamento em proporções adequadas.
- Sonda de tubo flexível com Balão para passar pela uretra, chegando à bexiga e permitindo a passagem de urina até o saco coletor.
- Sonda de drenagem em 2 vias.
- Válvula de ar de fácil manipulação.
- Via de irrigação.
- Capacidade do balão: o volume de líquido a ser introduzido no balão conforme orientação do fabricante.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

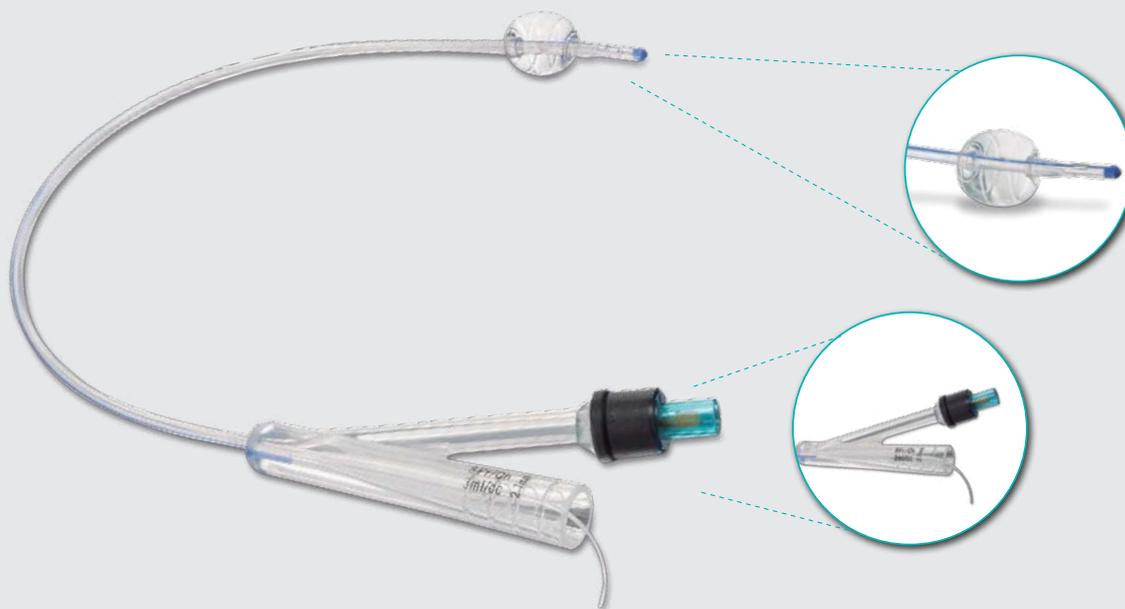

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510005

Código	FR	Capacidade de preenchimento do balão (ml)	Comprimento (mm)
4003.06	06	1,5	310
4003.08	08	3,0	310
4003.10	10	3,0	310
4003.12	12	5-15	400
4003.14	14	5-15	400
4003.16	16	5-15	400
4003.18	18	5-15	400
4003.20	20	5-15	400
4003.22	22	5-15	400
4003.24	24	5-15	400




## DRENAGEM DE CANAL ABERTO E CANAL ABERTO SIMPLES

### DETALHES DO PRODUTO

- Dreno 100 % Silicone.
- Absorção longitudinal, todo o caminho do tubo implantado.
- Com linha radiopaca em toda sua extensão.
- Seção de tubo de drenagem circular (80 cm de comprimento).
- Maior área de contato com secreções, absorção rápida e eficiente e maior conforto para o paciente.
- Modelo Canal aberto composto por: Drenagem, Trocarte e Reservatório.
- Modelo Canal Aberto Simples composto por: Drenagem, Trocarte, Conector Luer Slip, Tubo extensor e Reservatório.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

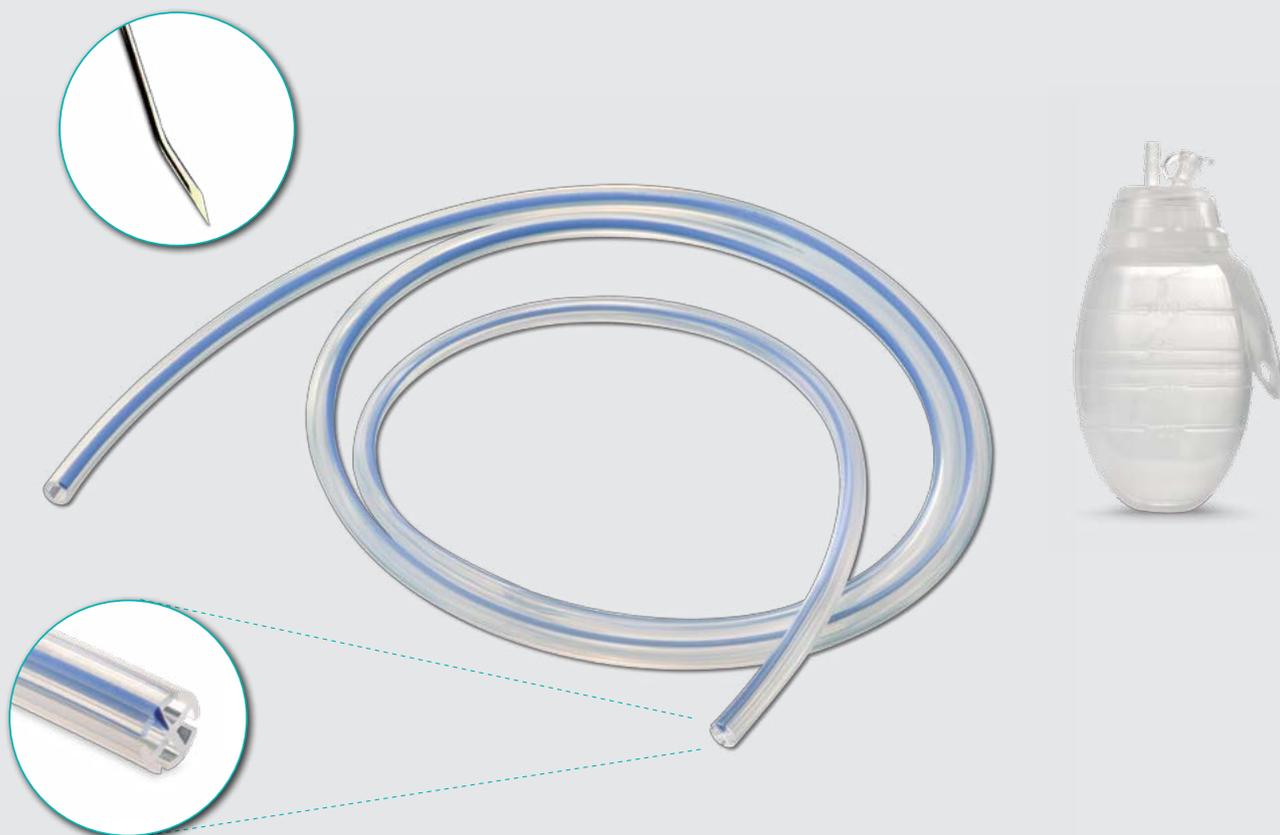

### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510013  
Cadastro Anvisa nº 81158510016



Código	FR	Diâmetro Externo do Tubo (mm)	Comprimento Canal Aberto (mm)	Comprimento total (mm)	Capacidade do Reservatório (cc)	Trocarte (FR)
3005.10.100	10	3,30	300	1200	100	10
3001.15.100	10	5,00	300	1200	100	15
3001.19.100	19	6,30	300	1200	100	19



## DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone transparente.
- Seção plana com “multiperfurados”.
- Lumens Interior. Melhora a drenagem de fluídos em qualquer ponto ao longo do segmento plano.
- Aumento da capacidade de absorção.
- Tubo radiopaco.
- Maior conforto para o paciente.
- Fácil manuseio.
- Redução do risco de obstrução do fluxo por acotovelamento, torção e / ou esmagamento.
- O sistema inclui drenagem trocarte e reservatório.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

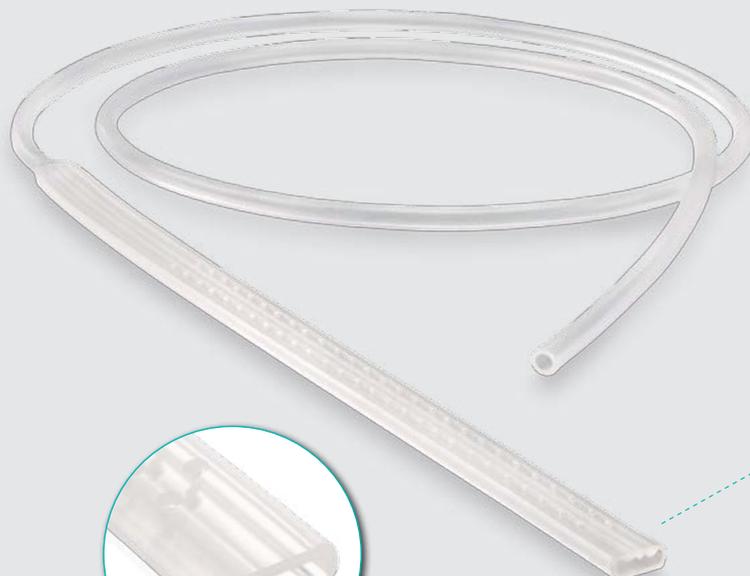

## Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510014

Código	Largura do perfurado(mm)	Comprimento perfurado (mm)	Comprimento total (mm)	Reservatório (ml)	Trocarte
3002.07.100	07	150	750	100	15
3002.10.100	10	200	1100	100	15



### DETALHES DO PRODUTO

- Adaptável a todo o tipo de drenagem.
- Válvula Anti-Refluxo.
- 100% silicone transparente.
- Com marcação de volume.
- A flexibilidade em silicone e a resistência permitem gerar pressão negativa para a aspiração.
- A transparência e a graduação facilitam a avaliação das características do líquido drenado.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510016

Código	Volume (ml)
3003.100	100ml
3003.200	200ml




## CATETER HSG BLENTO PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA (HSG) E HISTEROSSONOGRRAFIA (HS)

### DETALHES DO PRODUTO

- Cateter diagnóstico duplo lúmen, um dos lúmen para injeção de contraste e o outro para insuflação do balão.
- Bainha maleável transparente permite a fácil colocação do cateter.
- Ponta arredondada com orifício laterais.
- Pequeno diâmetro permite colocação próxima do probe de ultra-som.
- Torneira para inflar o balão da ponta do Cateter.
- Torneira branca para injeção do contraste.
- Kit com seringa para insuflação do Balão, bainha ou estilete de inserção e posicionamento, torneira e clamp corta fluxo.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

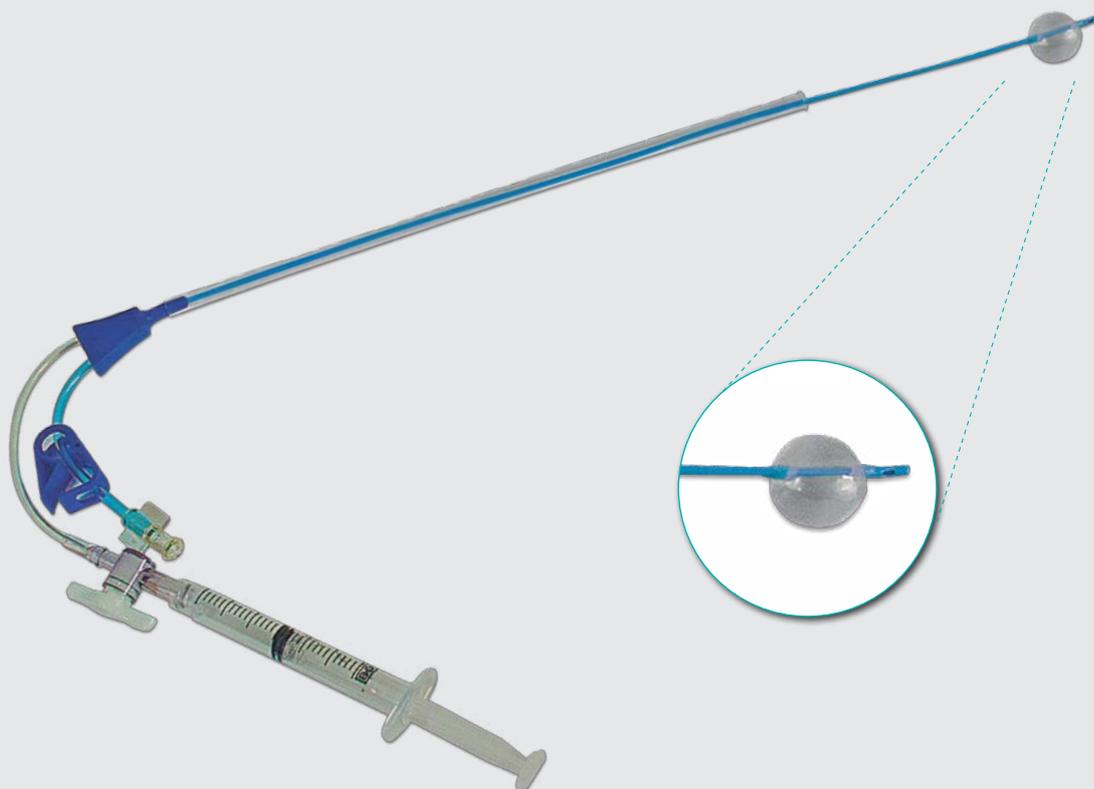


### Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510020

Código	FR	Comprimento do Cateter (cm)	Capacidade do Balão (cc)
7002.05	5,0	28	1,5
7002.07	7,0	28	3,0



Acesse nosso site



Alameda Mercúrio. 120  
American Park Empresarial  
Indaiatuba | SP - CEP 13347-662  
Telefone: +55 19 3825-3555  
[www.blentamedical.com](http://www.blentamedical.com)