


DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone com linha RADIOPACA.
- Extremo distal fechado e arredondado com 2 orifícios laterais.
- Marcado a 20 e 30 cm para os códigos 2004.04 e 2004.06 e 20, 30, 40 e 50 cm para os códigos 2004.07 e 2004.09.
- Não produz úlceras de pressão.
- Maior conforto para o paciente.
- Sem atrito doloroso durante a colocação.
- Menor risco de obstrução por flexão ou acúmulo de solução.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.

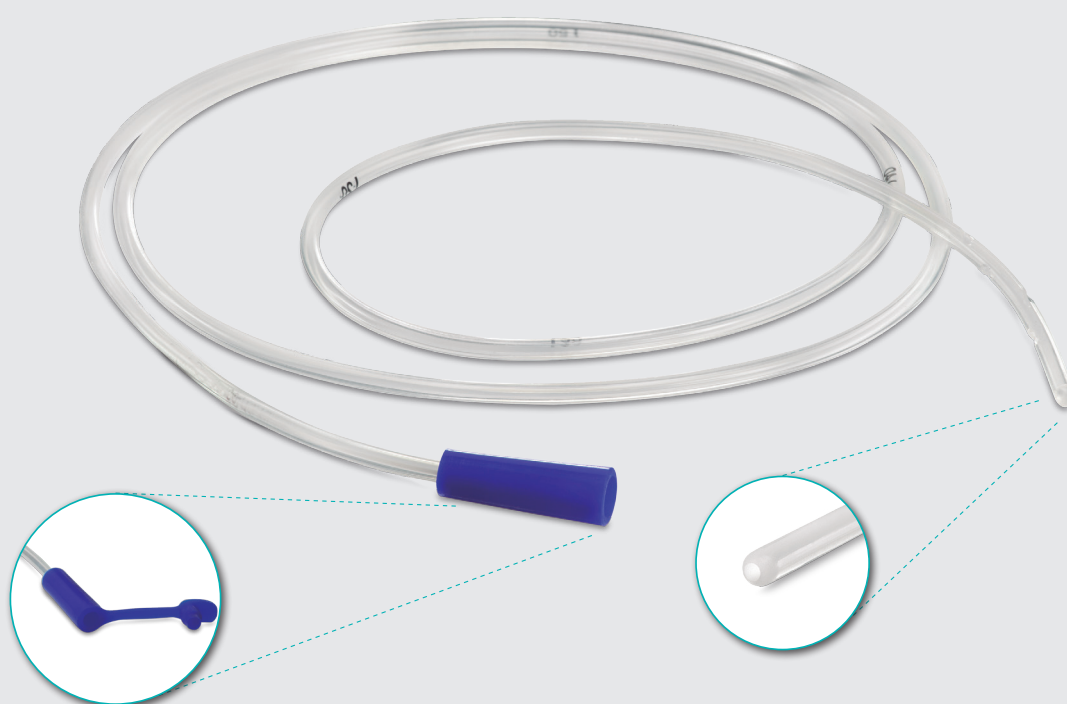

Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510001

Sonda Nasogástrica - Pediátrico				
Código	FR	ø Externo (mm)	ø Interno (mm)	Comprimento (mm)
2004.04	4.0	1.40	0.75	450
2004.06	6.0	2.00	1.00	450
2004.07	7.0	2.30	1.25	1050
2004.09	9.0	3.00	1.75	1050

2 perfurações laterais